


がんリスク、 考えたことはありませんか？

今の選択があなたの未来を変える

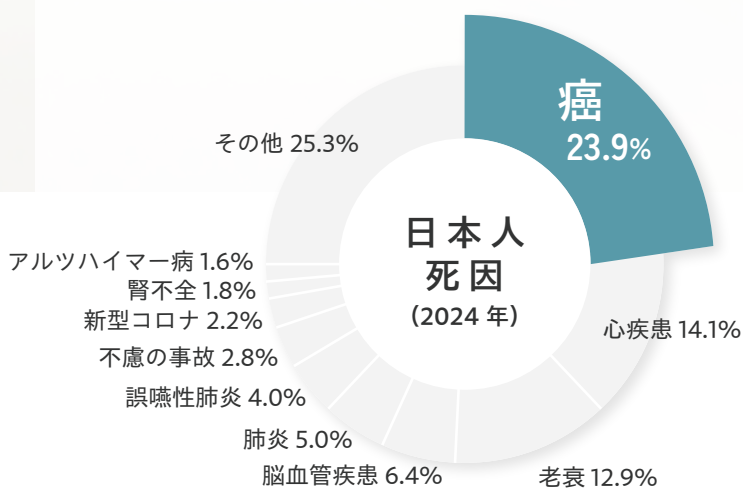


厚生労働省「人口動態統計 (確定数)」 / 2024年

がんは2人に1人になる時代

ステージ別5年生存率 (2014-2015年登録)

部位別の全国がん死亡者数 (男女 2023年)

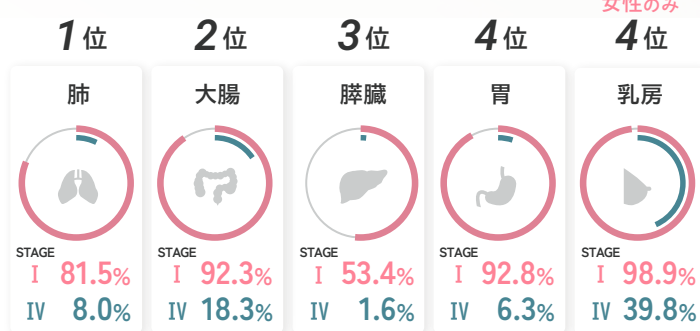


出典：国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」

検診の“盲点”になりやすい 膵がん

一般的ながん検診のメニューには「膵臓」の項目は入っていません。早期発見が難しいとされる部位だからこそ、定期的なリスク評価が重要です。

がんは待ってくれない がんの進行スピード例


がんは進行すると成長が速くなるため、早期発見が極めて重要です。そのため、生活習慣の改善や検診の活用を通じて、がん化するリスクがある段階から適切に管理することが大切です。

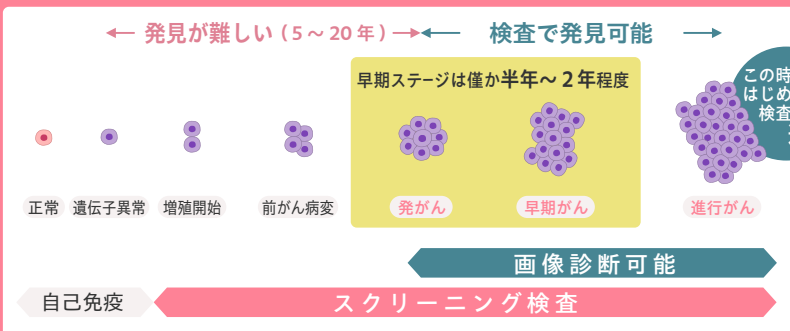

SalivaChecker®

サリバチェッカー

とは



だ液を採取、ポストへ投函。

6種のがんリスクを評価。

膵がんも早期ステージから



がんは早期発見が大切

MEP 南青山

健診・人間ドック
オプション検査

24,200 円(税込)


サリバチェッカーはAI（学習モデル）を用い、測定だ液中の代謝物の特徴を解析

Q どうしてだ液からがんのリスクがわかるのか

A がんにかかると、だ液中の代謝物が変化するため

これまでの研究から、がんになることで、ポリアミンをはじめとしただ液に含まれる代謝物の特徴が変化することが分かっています。

サリバチェッカーではAI（学習モデル）を用い、測定だ液中の代謝物の特徴が、がんの方とがんでない方のどちらに近いかを解析することで、がんのリスクを評価します。

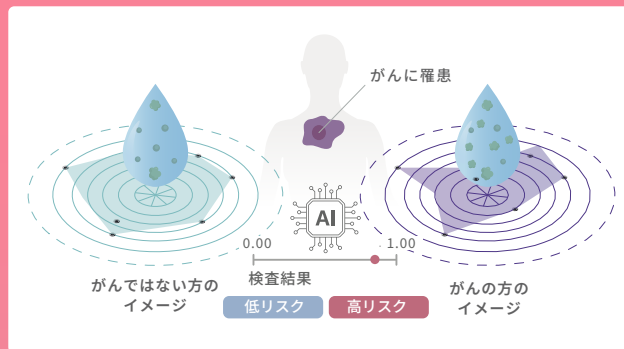


研究に裏打ちされた、確かな信頼を

慶應義塾大学 先端生命科学研究所の、代謝物を専門的に研究するメタボローム（代謝物）研究と臨床データに基づき開発。

がんリスク・スクリーニング検査である「SalivaChecker®」が誕生。

消化器外科医の代表の想いと、科学的根拠のあるリスク評価です。

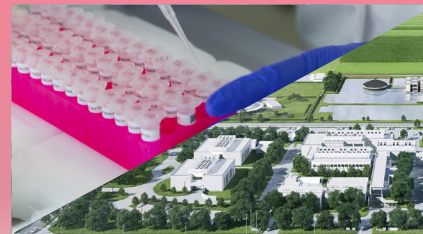

検査の流れ

オンライン相談・電話相談

検査結果にご不安・ご相談があった場合、ご利用いただけます。また相談できる医療機関をサリバテック社のホームページで公開しています。

検査手順のご紹介

1. 検査のお申込み



2. 検査キットが自宅に届く



3. だ液を採取



4. 採取当日にポストに投函



5. 検査結果の確認



Q&A 検査の流れ

よくあるご質問はこちらよりご確認ください。

<https://salivatech.co.jp/faq/>



Q だ液によるがんリスク検査（SalivaChecker）は必ずがんを発見できますか？

A 本検査は、がんを診断するためのものではなく、だ液を採取した時点でのがんのリスクを調べる検査です。高いリスク値が出てがんの発見につながる場合もある一方で、リスク値が低い場合でもがんがある可能性もあります。必ずがんを発見できるというものではありません。リスク値が高い場合には、検査を受けた医療機関にご相談いただくことをお勧めします。

Q 現在がんや他の病気で治療中ですが検査を受診できますか？

A 本検査を受診することはできます。ただし下記の方はリスクに影響が出る可能性があります。
・がん治療中、治療後半年以内の方
・リウマチの炎症活動期の方
・妊娠中、授乳中の方
・身体に炎症がある方（怪我や火傷など身体に熱を持って痛みがある、風邪をひいているなど）
上記の方は、症状が落ち着き次第または完治後に受診をお勧めします。

Q SalivaCheckerを受ければ他のがん検査は受けなくても良いですか？

A 本検査はだ液を採取した時点でのがんのリスクを調べる検査です。各検査には長所と短所があり、互いに補い合っています。また本検査は他の検査同様、偽陽性（本当はがんには罹患していないのに検査で陽性になること）・偽陰性（本当はがんには罹患しているのに検査で陰性になること）となる症例を含んでいます。サリバチェッカーと他の検査を併用することで、がんを見つけ出せる可能性は高くなります。

MEP 南青山

よりお申込みの方

検査料：24,200 円(税込)

<https://www.salivachecker.com/?campaigncd=231107>

※医師による診断に代わるものではありません

お申し込みはこちらから



採取キット提出期限：キット発送から3ヶ月

※期限内にご提出いただけない場合は、検査結果をお返しすることができません。

検査キット開発元/検査・測定機関

SalivaTech 株式会社サリバテック 住所/山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2

URL <https://salivatech.co.jp/>

©2024 SalivaTech Co., Ltd. all rights reserved. 本資料の改変や、掲載してある文章やイラスト等の無断転載を禁じます。

お問い合わせ



2026.04 [医療機関 A4]